esrf1108_ec337_summary3.ppt

I1017_6_20

i1017-6-20

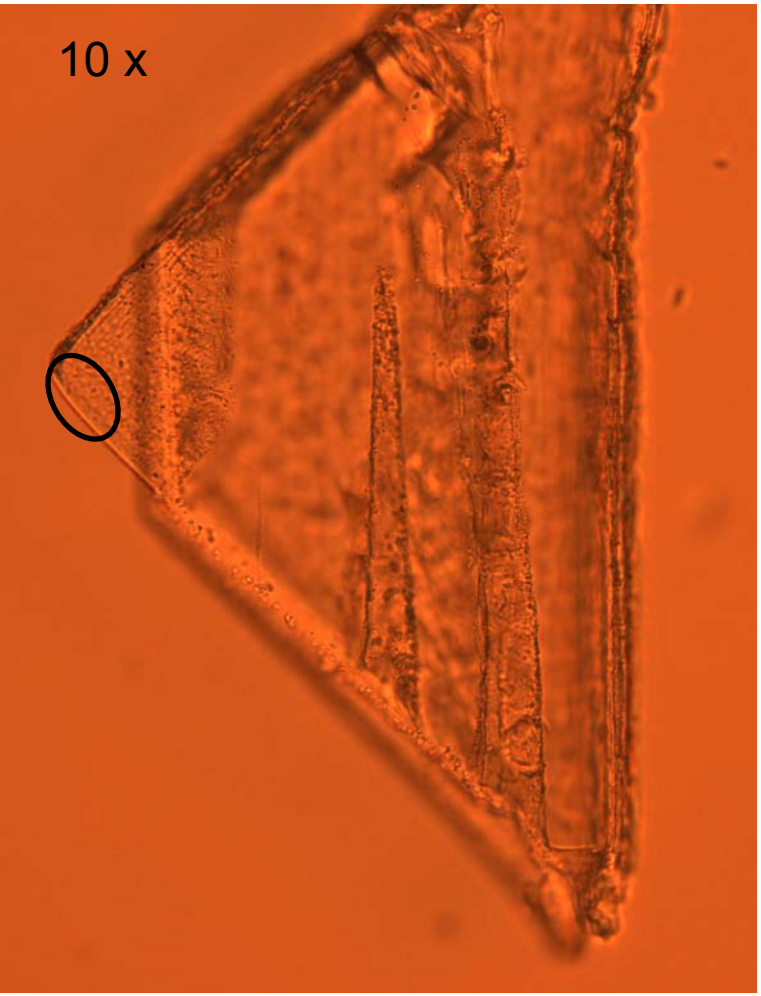

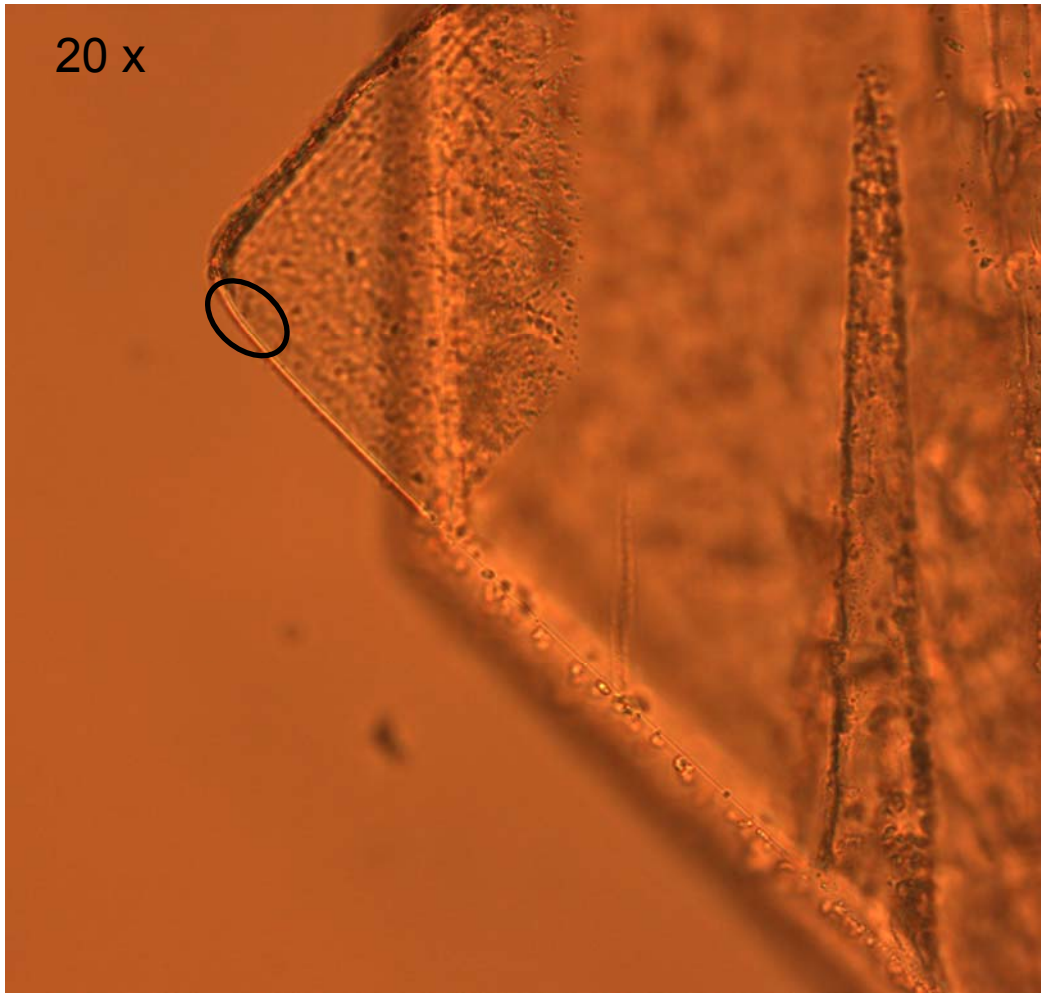

i1017-6-20

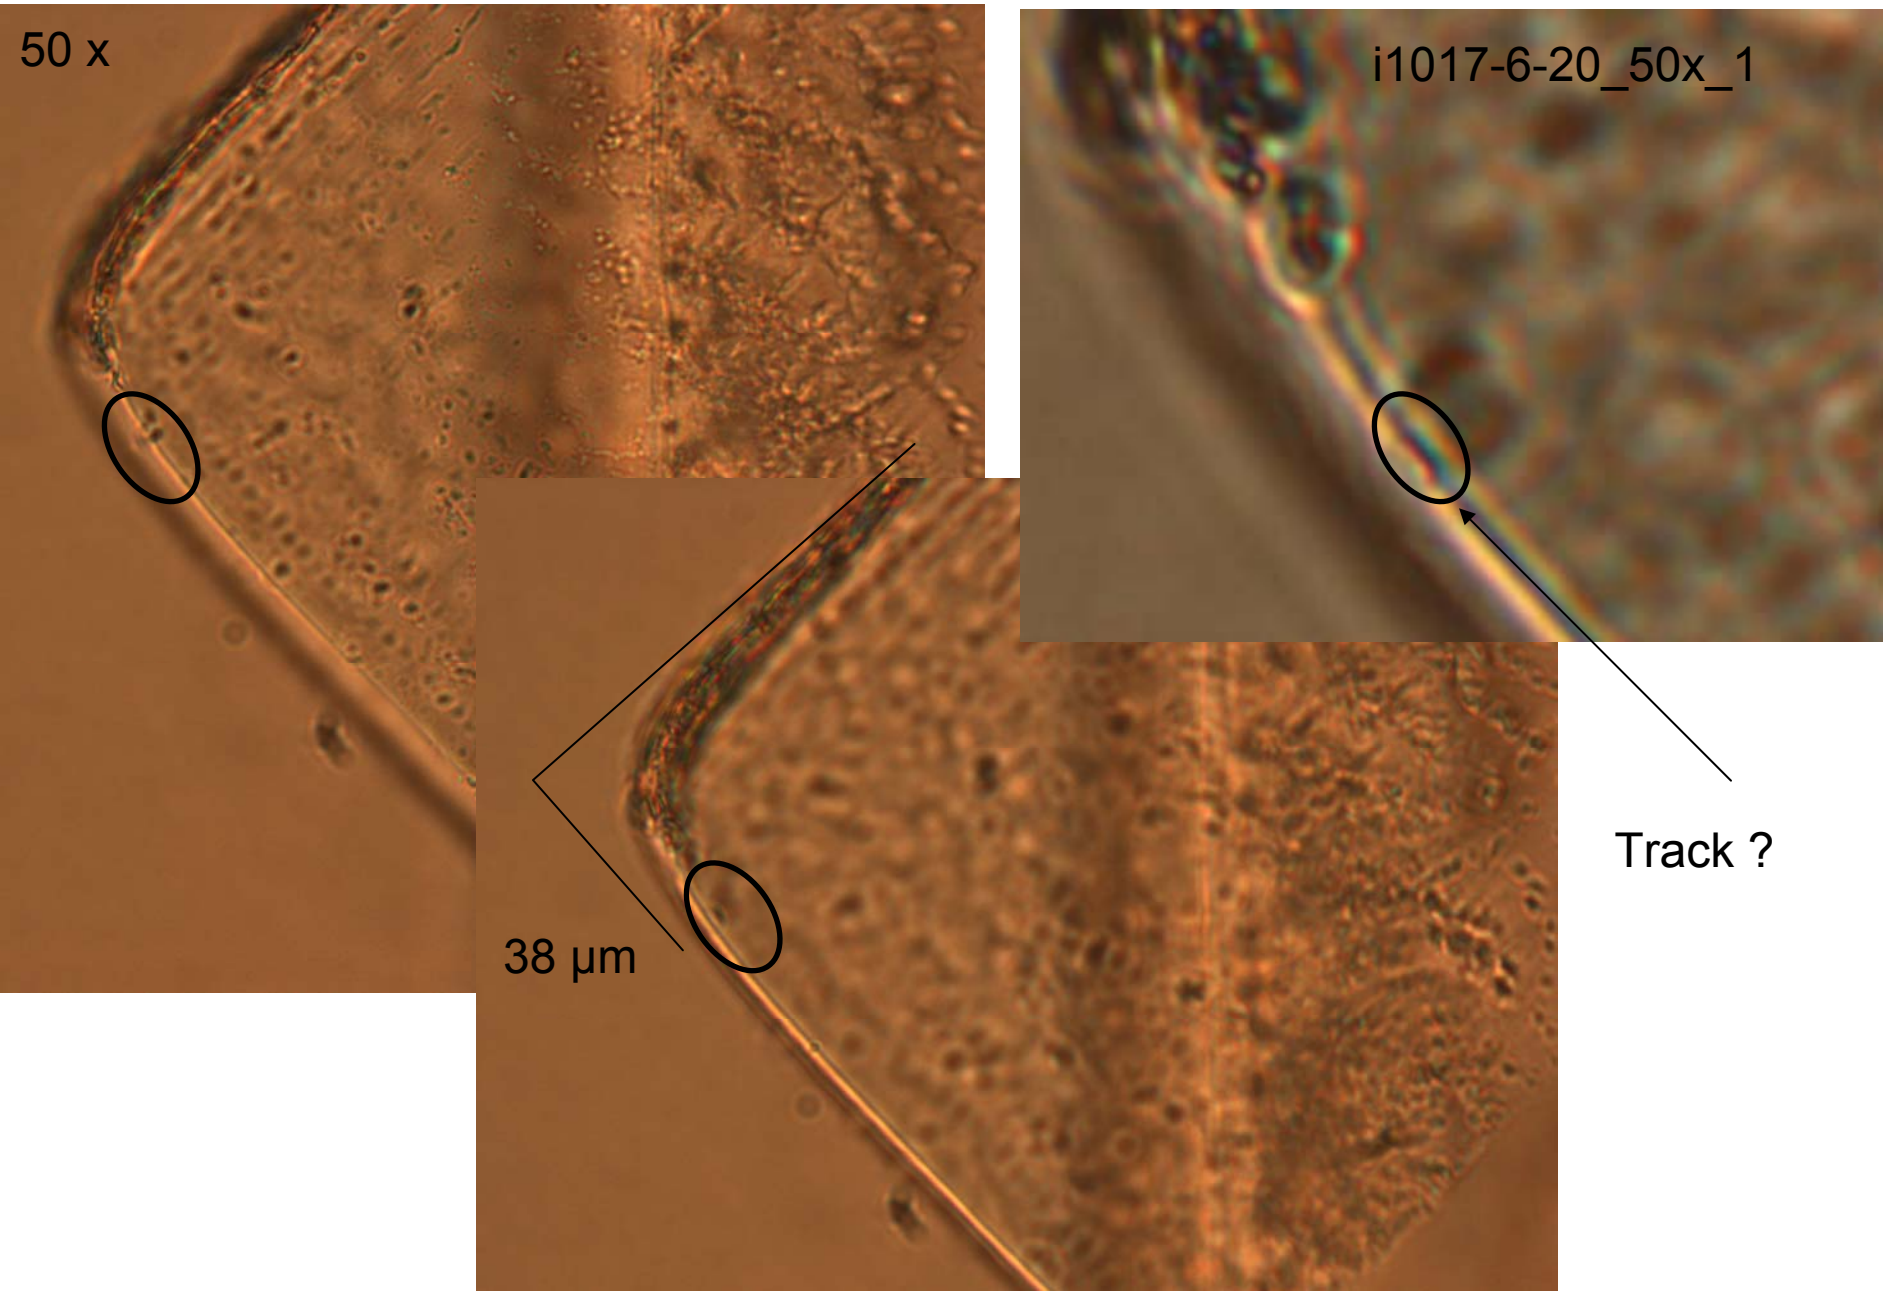

i1017-6-20

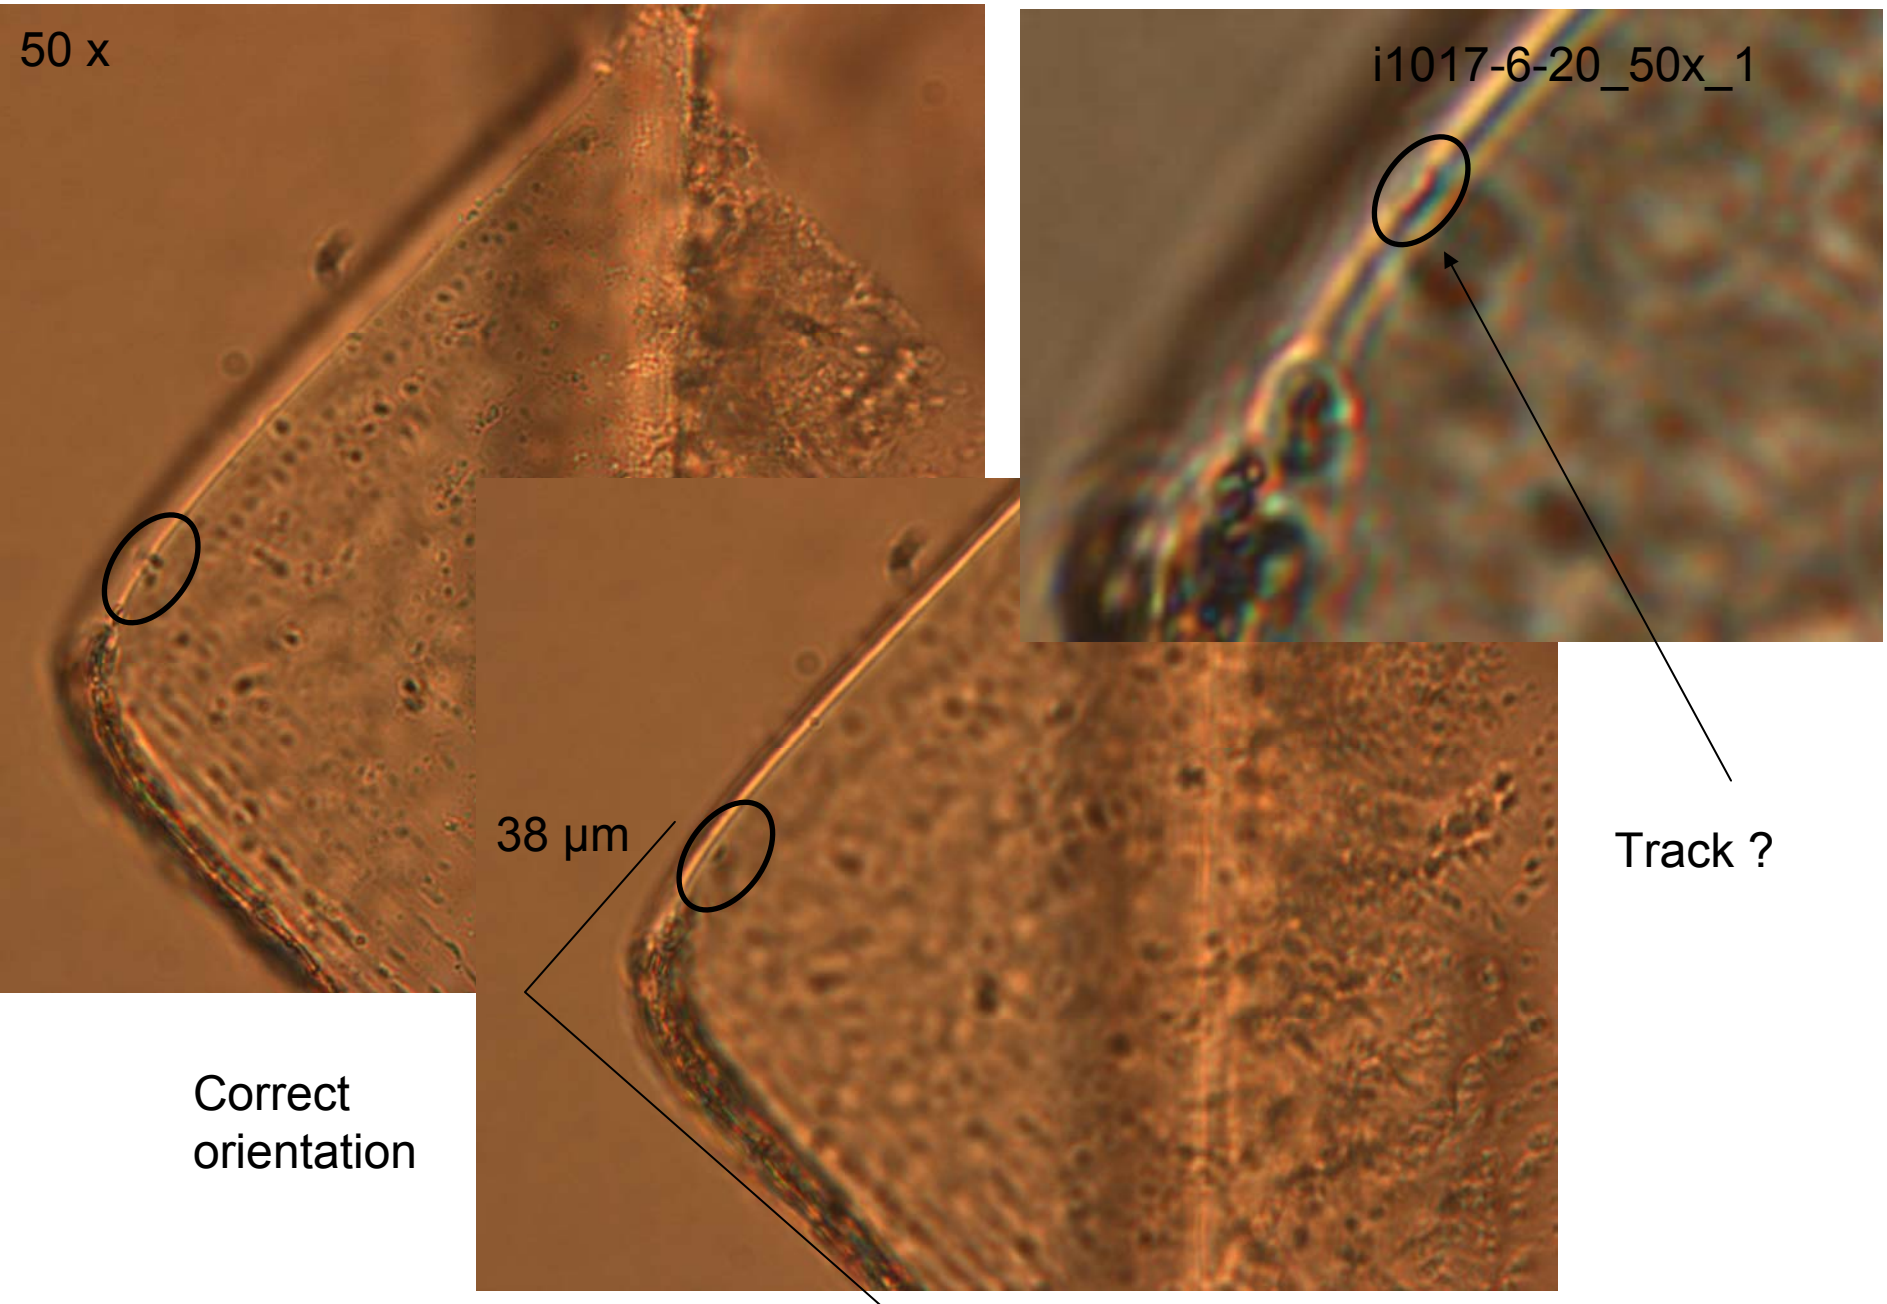

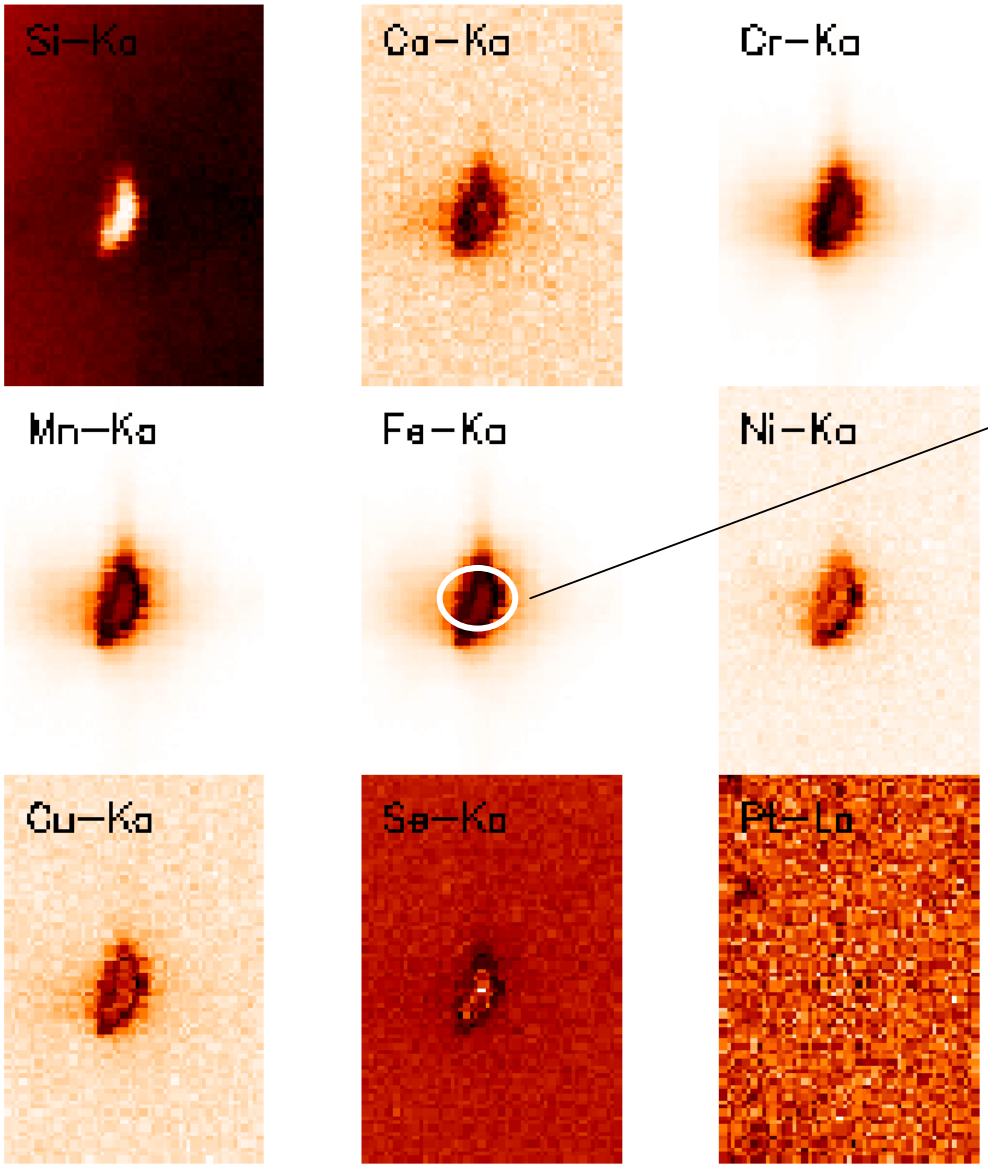

Scan55
fb0_193i
51(0.2μm)x76(0.2μm)

LT 4sec
Conventional mode

detector saturated!

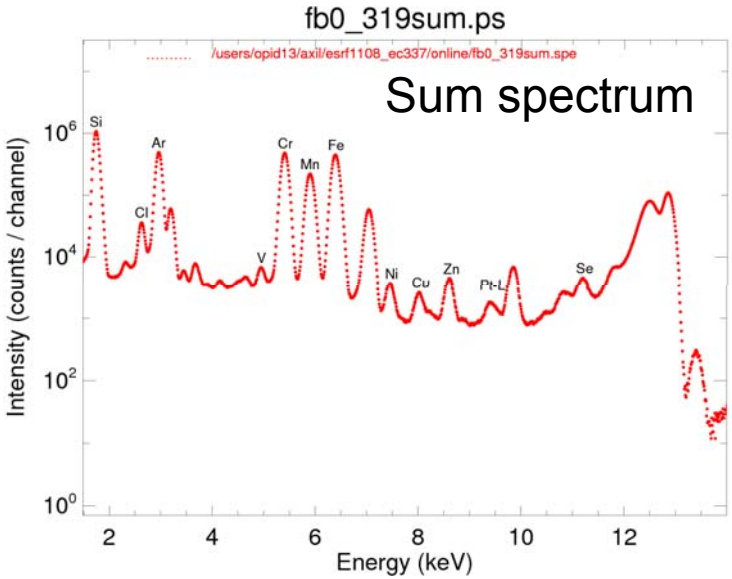

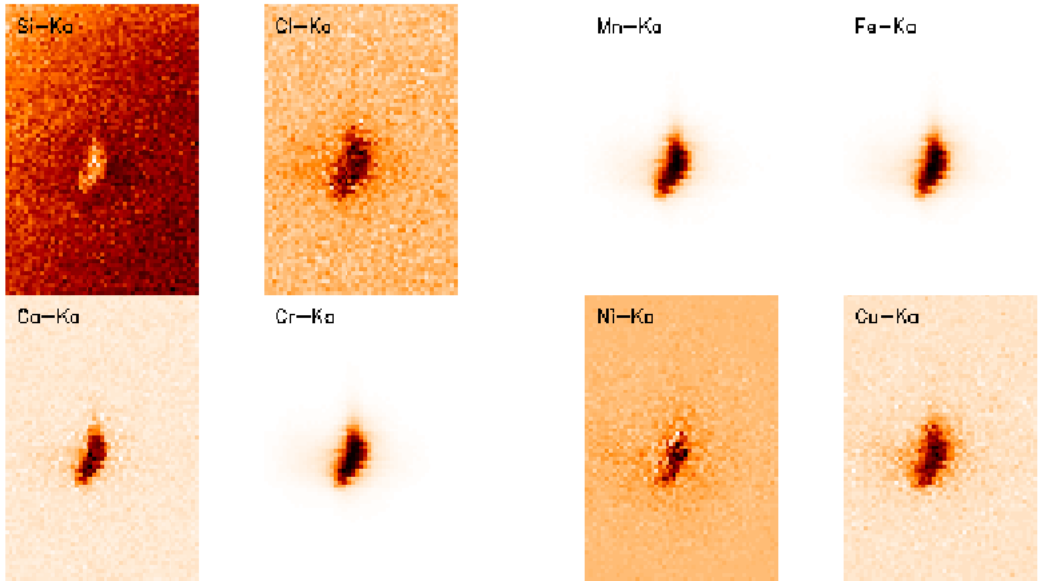

Scan55
fb1_193i
51(0.2μm)x76(0.2μm)

LT 4sec
Confocal mode

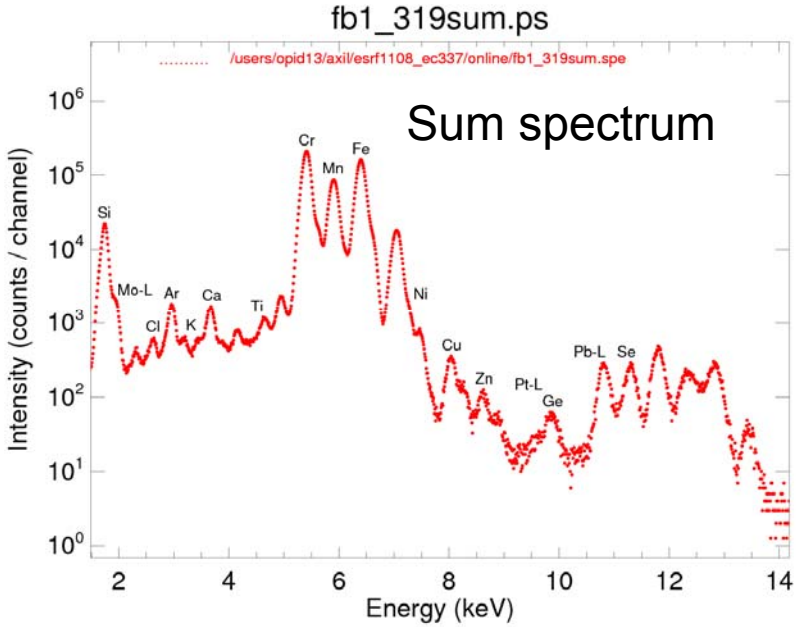

Fb1_374i
Scan 113

16(0.2)x26(0.2)x30

dscan mez
on particle

(vertical)

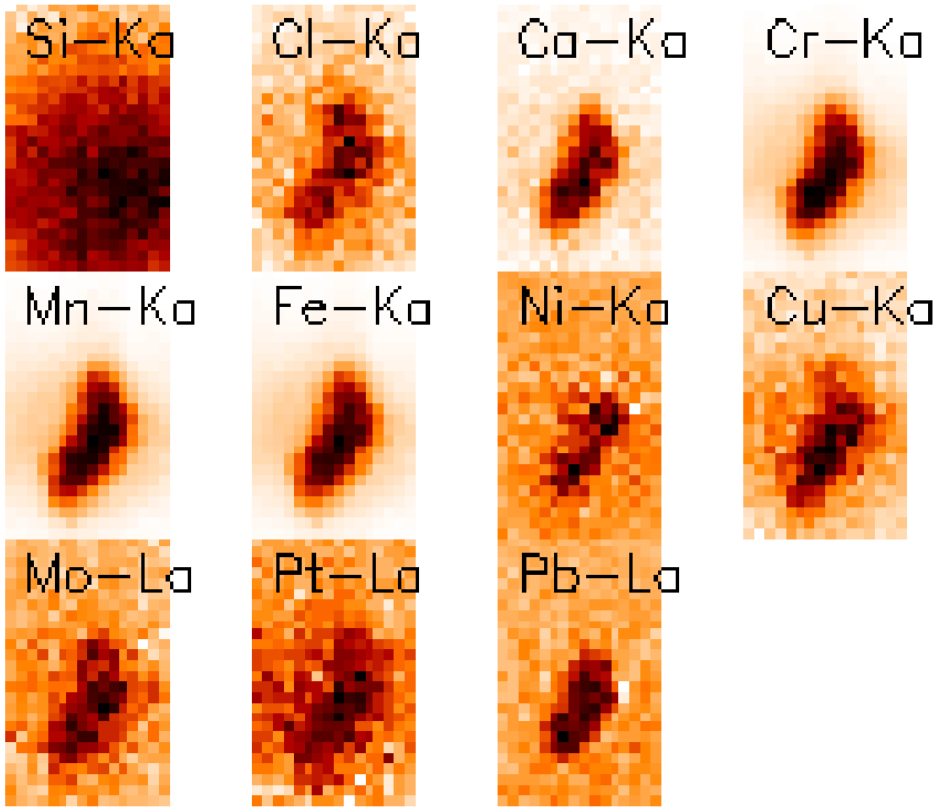

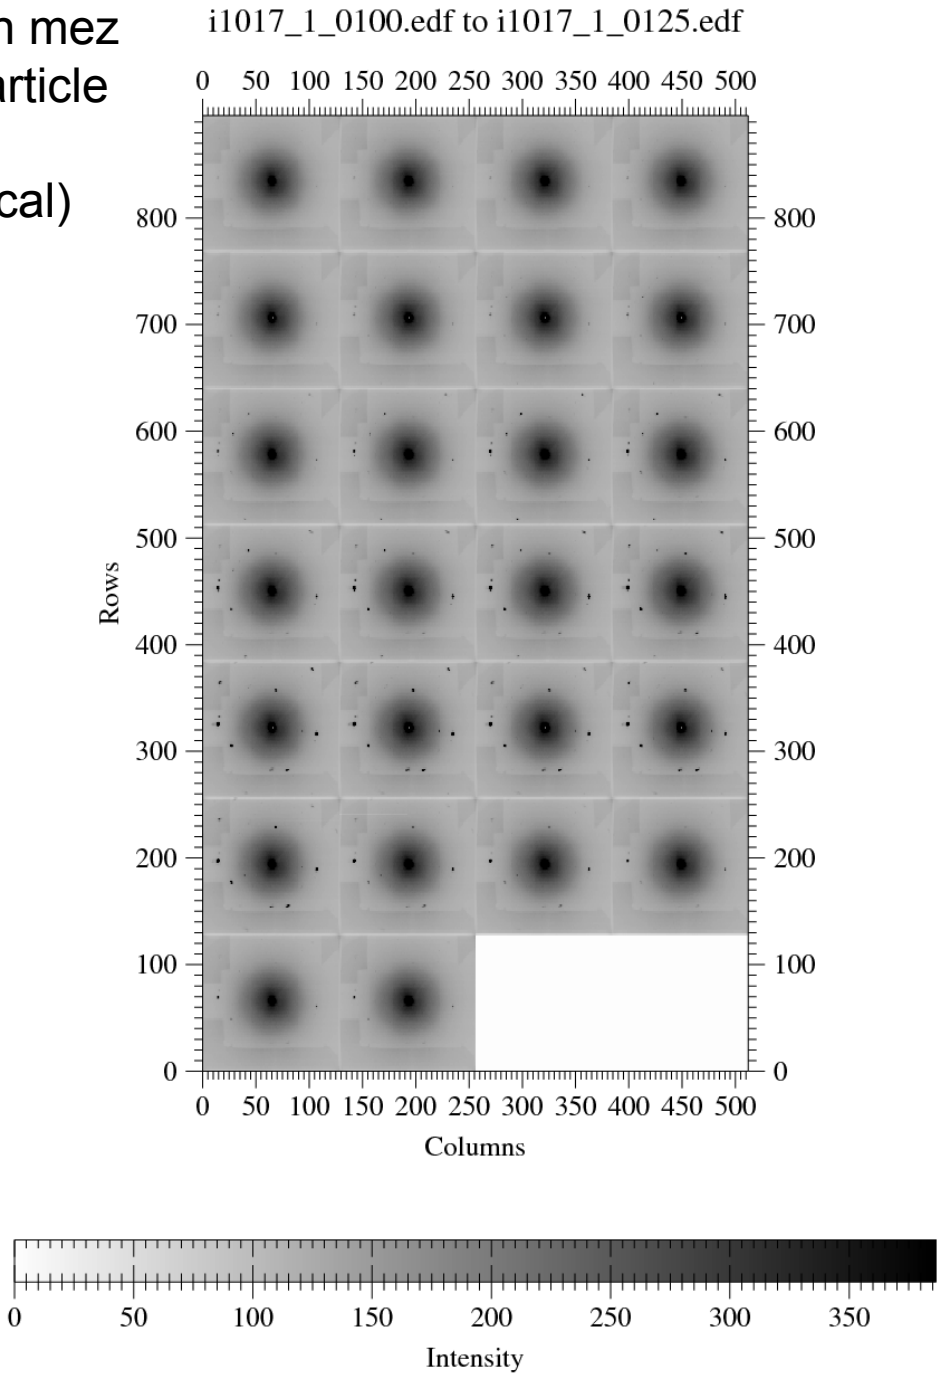

Fb1_403i
Scan 124

101(1)x101(1)x3

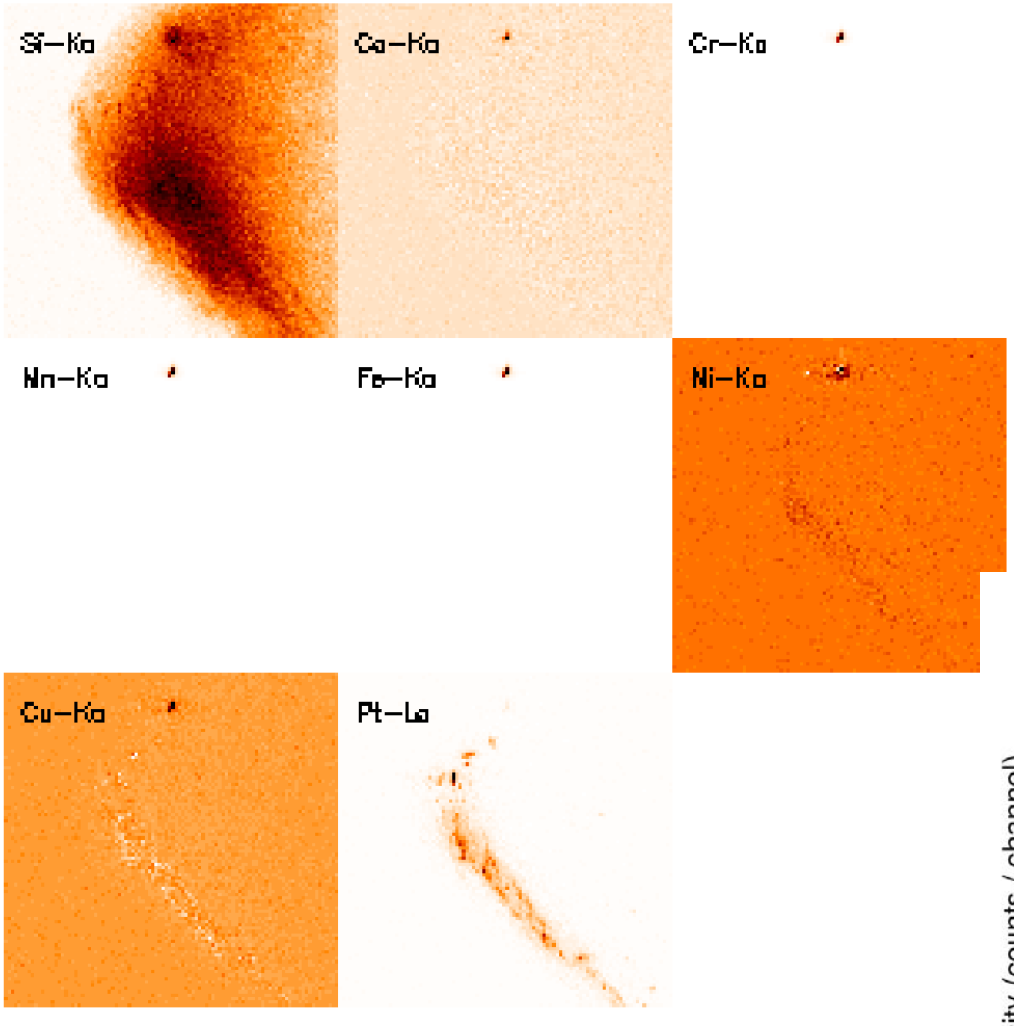

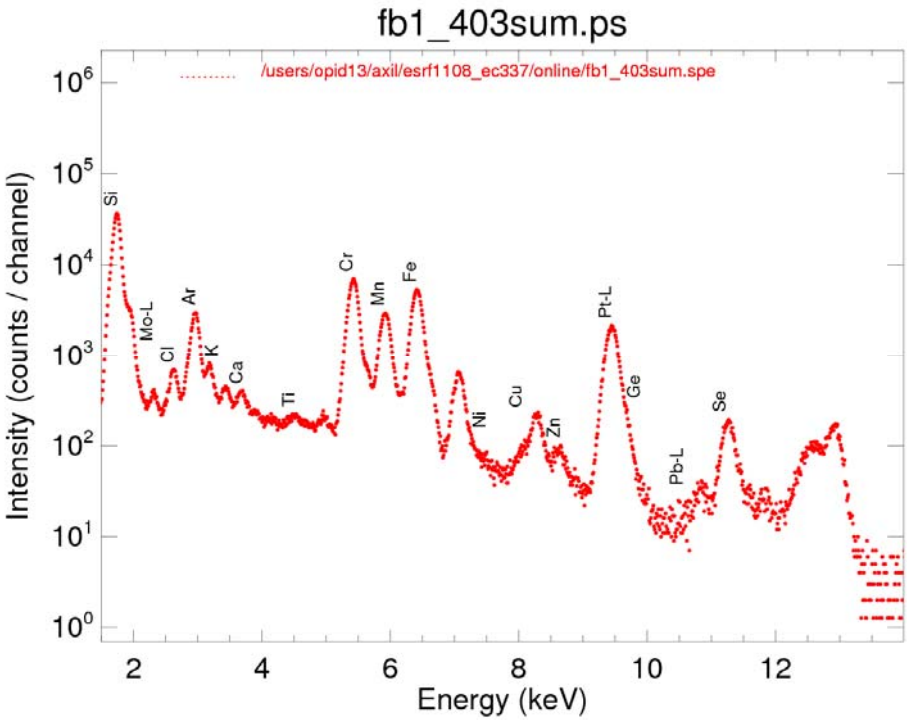

Fb1_494i
Scan 193
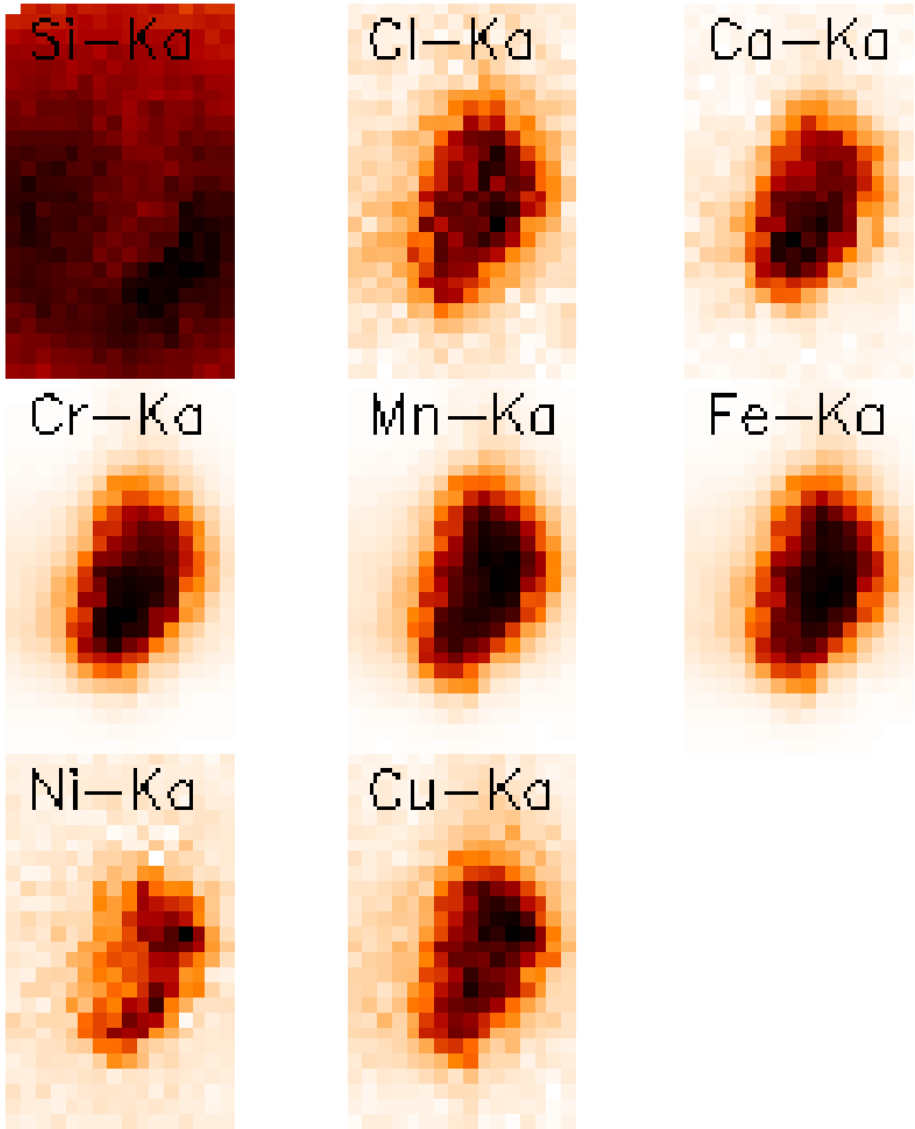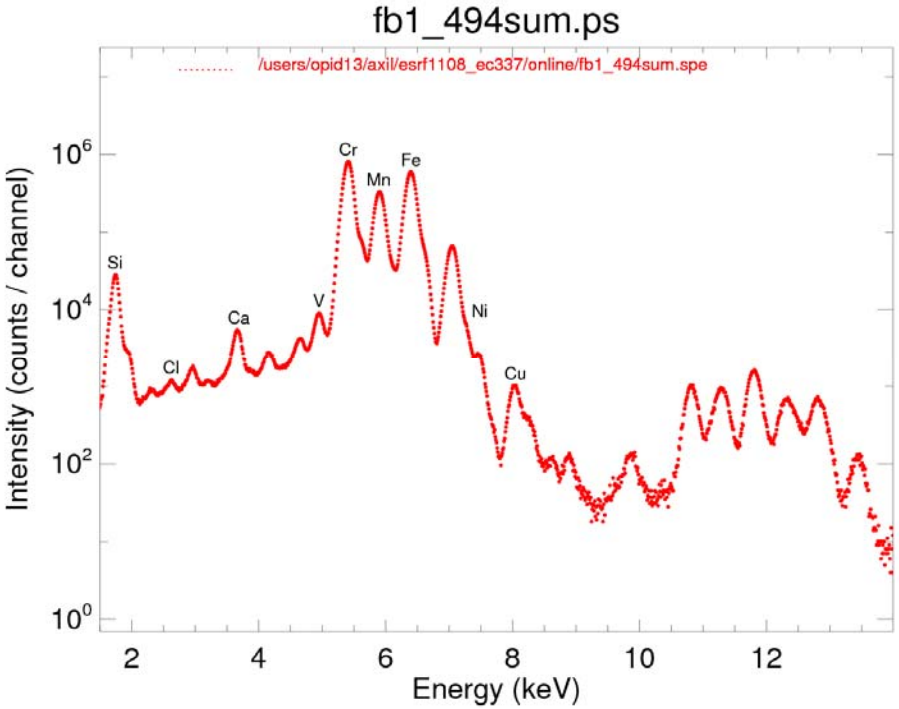
Combined XRD & XRF